

ฉลากขวด ทุกขนาดบรรจุ

59 mm

22 mm

 For Skin Prick Test AllerVACtest[®] NEGATIVE CONTROL No Active Ingredient ผลิตโดย : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร็ดเตอร์ฟาร์มา จำกัด จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เกร็ดเตอร์มายาซิน จำกัด	น้ำยาทดสอบภูมิแพ้ควบคุมลบ น้ำยาสำหรับทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยการสะกิด ใช้ทดสอบภายนอกร่างกายภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น วิธีใช้ : ดูรายละเอียดในเอกสารกำกับยา เก็บไว้ในที่อุณหภูมิ 2-8 °ซ และพ้นจากแสงแดด Store at 2-8 °C. Protect from light. Reg. No. XXX Batch. No. Mfg. Date. Exp. Date.	 ต้อง ติดตาม ยาควบคุมพิเศษ ใช้เฉพาะสถานพยาบาล
---	--	---

ขนาดขยาย


ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของ
ภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตามมาตรา 25(3) หรือ
27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี

ฉลากกล่อง ทุกขนาดบรรจุ

63 mm

30 mm

65 mm

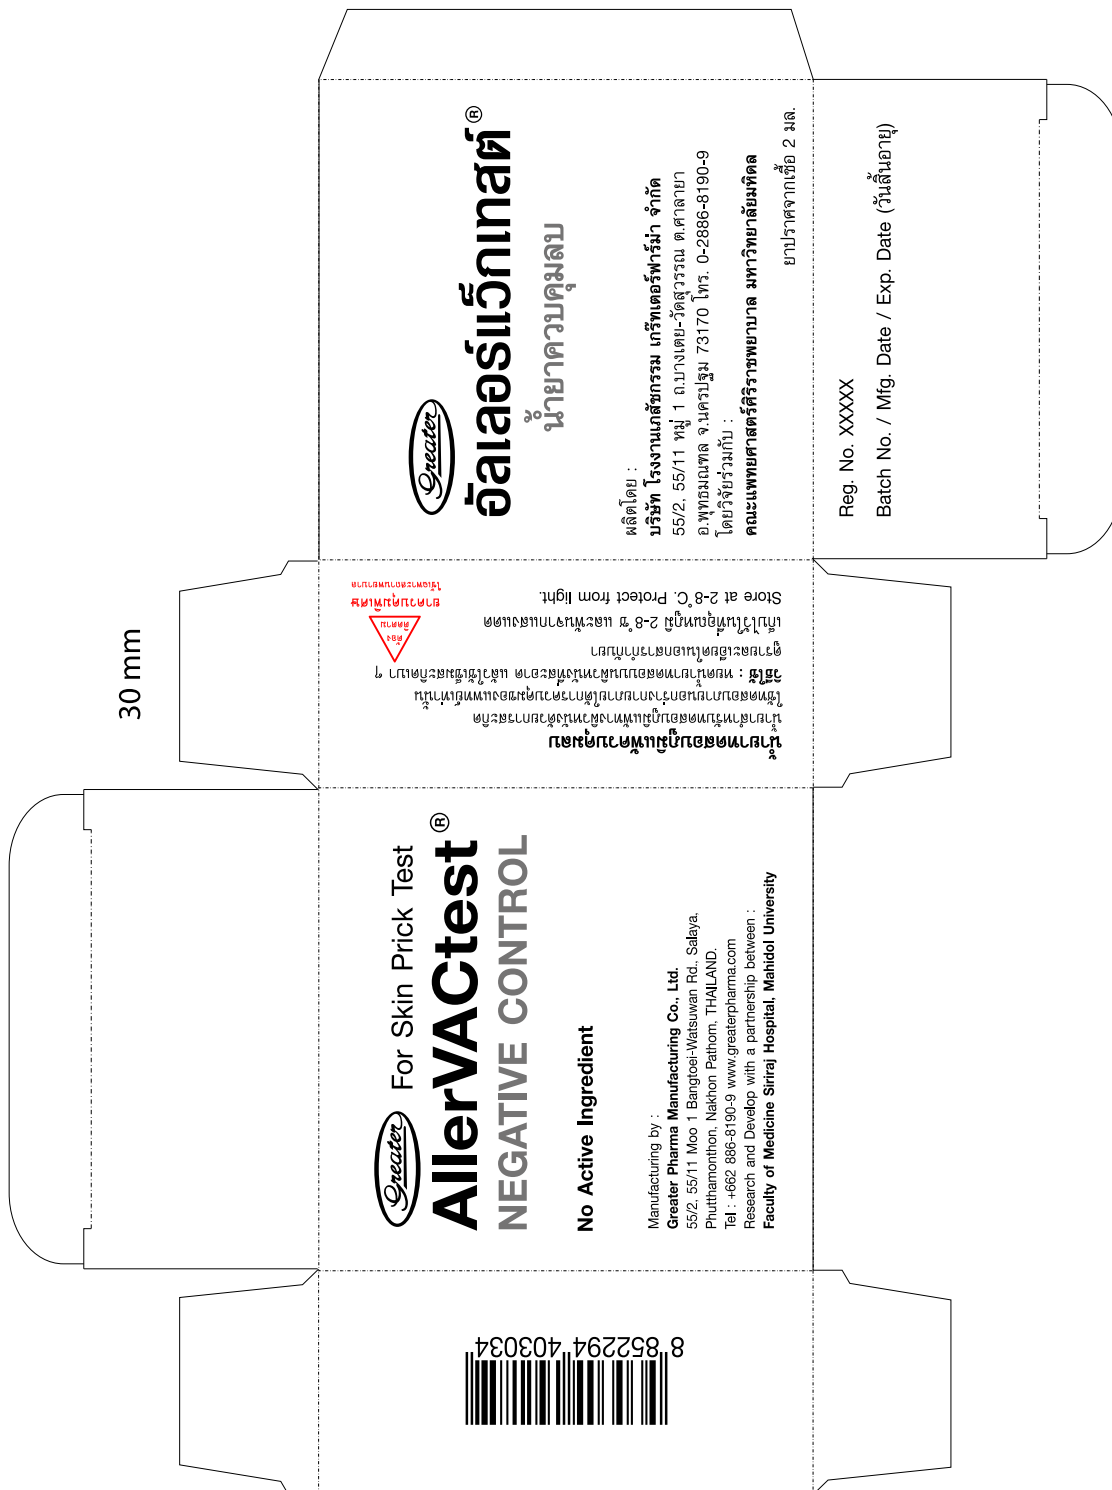

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของ
 ภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
 ถูกต้องตามมาตรา 25(3) หรือ
 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี 3.1.1.1 Pg. 2