


ฉลากหลอดบรรจุยาขนาด 2 ml



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ  
ทุกชนิดและหีบห่อ ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕  
(๓) หรือ ๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ก.ค.ด.


ฉลากหลอดบรรจุยาขนาด 4 ml

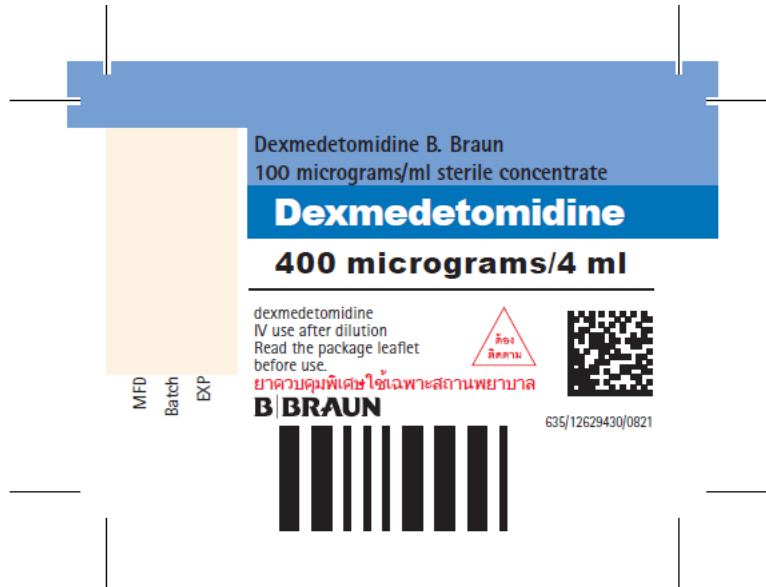

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ  
ทุกชนิดและหีบห่อ ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕  
(๓) หรือ ๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉ. ๑๑.

ฉลากหลอดบรรจุยาขนาด 10 ml

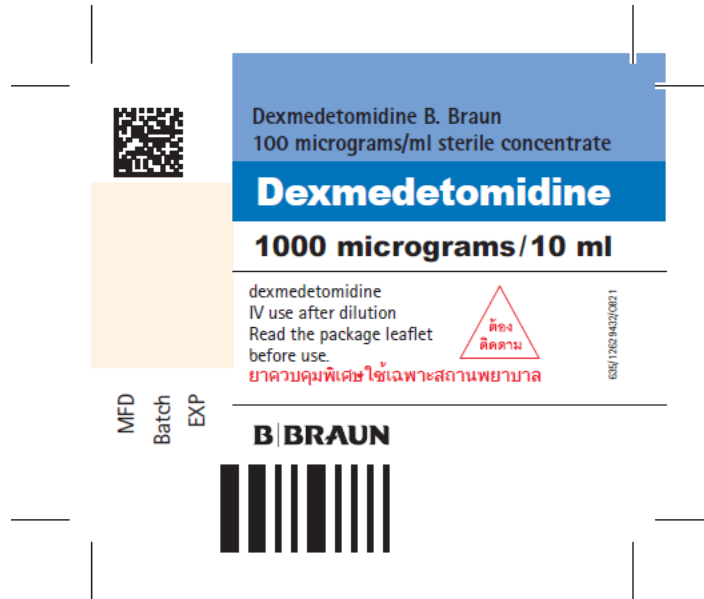

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ  
ทุกชนิดและหีบห่อ ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕  
(๓) หรือ ๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ก.ค.ค.