


ฉลากยา

ฉลากปากกา

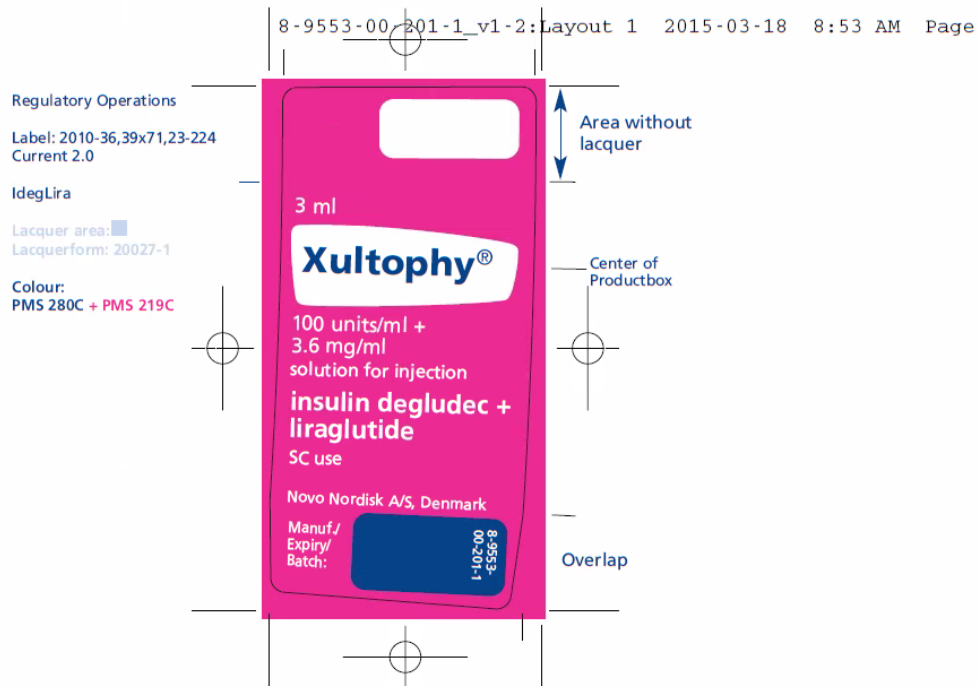

ขอรับรองว่าฉลากมีขนาดไม่เกิน 3 ตารางนิ้ว
ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) และ 3 แล้วแต่กรณี
นันทนัช มัททชนโกศัย

ฉลากยา Xultophy® บนปากกาฉีดยาชนิด PDS 290 (inner label)

ฉลากกล่อง

8-9553-00-311-1_v1-2:Layout 1 2016-02-10 11:13 AM Page 1

Regulatory Operations
 Carton: 2010-22-521-00-326
 Current 3.0
 Lacquer free area:
 Lacquerform: 30271-1
 Braille No.: XXXX-XX-X
 Placement: Front
 5 Pcs
 Colour:
 PMS 280C +
 PMS 289C +
 Cyan +
 Black +
 PMS 219C



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
 ถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) และ 3 แล้วแต่กรณี
 นันทนัช มัทธอนโกไทย

ฉลากยา Xultophy® บนกล่องบรรจุยา (unit carton)